



User Guide

## Standard Breast Examination Trainer

乳房診察トレーナー スタンダード

品番 **140200**



## 乳房診察トレーナー スタンダード

### 品番 140200

乳房診察(CBE)に求められる繊細な技術を習得するための製品です。実物のような柔らかな組織と交換可能なさまざまな病変部から構成される製品は卓上での使用に加え、模擬患者が身につけて使うこともできます。OSCEプログラムにおいて理想的な製品であり、現実的な診断技術を教えるのに最適です。

#### 習得できる技術

- 乳房診察技術 (CBE、SBE)
- 医師と患者とのコミュニケーション
- 解剖学的なランドマーク
- 病変部の位置と診断

#### 特長




- 柔らかな組織は実物のような外観と感触
- 模擬患者が長時間つけていても快適
- 容易な着脱
- 卓上と装着の両方で使用可能
- 悪性腫瘍(2cm、3cm、5cm)や嚢胞、線維嚢胞、線維腺腫を任意の部位に設置することができ、簡単に交換可能
- 卓上で使用するためのトルソが付属
- 非ラテックス素材

#### 構成

- 着脱可能な診察用乳房
- 乳房診察用トルソ 140208
- 乳房診察用病変モデル 140203


4

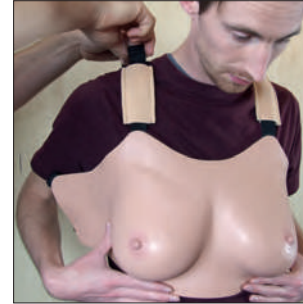

上部のストラップを調整し、乳房を好みの高さ調整します。

下部のストラップをします。

5

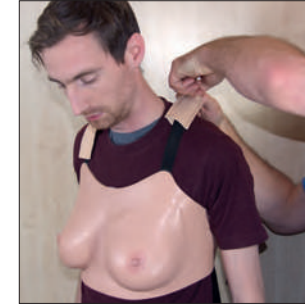


ストラップパッドを肩の位置までスライドします。

これで準備ができました。

## 装着の手順

1

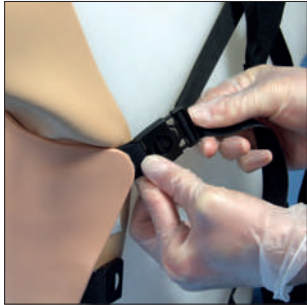

トルソから乳房を取り外します。

上部のバックルを再接続し、下側だけつなげない状態にすると次の工程がスムーズです。


2



上部のストラップに両手首を回し回します。

ストラップの上部をつかみます。

3

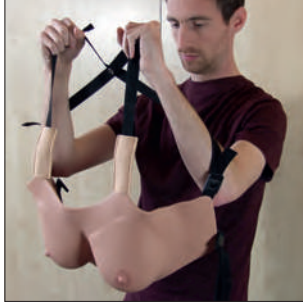

ストラップをもったまま乳房を引き寄せ、頭部にくぐらせます。

両腕が上部のストラップと1でつなげた側面のコネクタの間に収まっていることを確認して下さい。

## 構成 品



乳房



乳房診察用インサート  
品番: **140205**




乳房診察用病変サポート  
品番: **140206**



乳房診察用バックプレート  
品番: **140207**



乳房診察用トルソ  
品番: **140208**

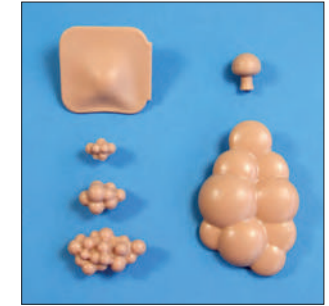

乳房診察用病変モデル  
品番: **140204**


## オプション 品



乳房診察用リンパ節パッド  
品番: **140203**

## 病変設置の手順

1

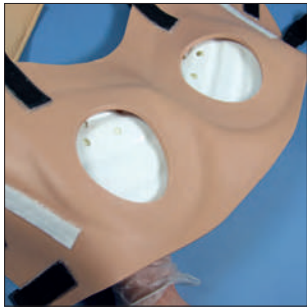


乳房診察トレーナーの5種の病変です。

- ・線維腺腫
- ・3種の悪性腫瘍
- ・嚢胞と線維嚢胞

病変を設置する際は、トルソ/模擬患者から乳房を外し、逆さにして行ってください。

2

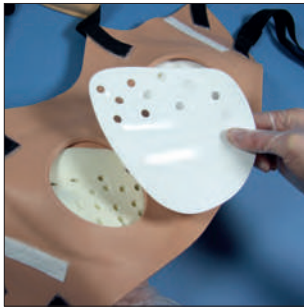


病変を付けたい側の乳房から、プラスチック製のバックプレートを取り出します。

3



ウレタン製の病変サポートも同様に取り出します。

1

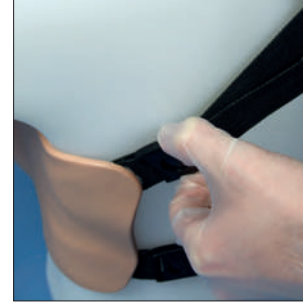

両側の上部のストラップを緩めます。

2



片側のバックルを外します。  
トルソ後部のスナップボタンをはずします。

3



これでトルソから乳房が取り外せます。

## トルソから乳房を外す手順

4



下側の端部までしっかりとパウダーを塗布します。

凹面もまんべんなくパウダーが塗布されるようにします。


5



インサートを乳房に戻す前に、インサートの形状(ふくらみ)を確認してください。

インサートを乳房の凹部に差し込みます。

6

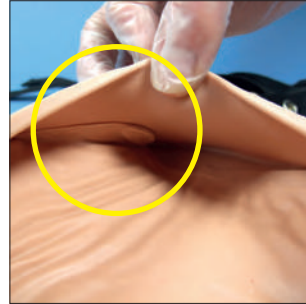

インサートの端部が折り込まれていないか確認します。

折り込みができてしまった時は、指で簡単に折り込みを戻すことができます。

乳房の皮膚の状態を確認し、必要に応じてインサートの位置を正しい位置に調整をしてください。


4



設置したい病変を病変インサートにしっかりと差し込みます。

病変インサートのホールは多少きつめに作られているので、病変は回しながら押し込んでください。


5

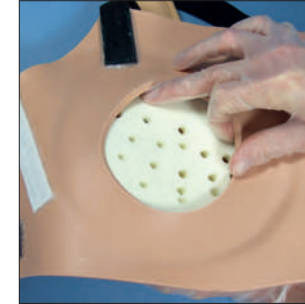

病変サポートを胸部の中に戻します。

病変サポートを戻す際に、向きを間違えないようにしてください。(上図が正しい向き)

6

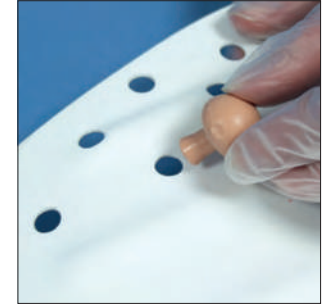

バックプレートに設置した病変をとり、ホールに挿入します。

病変インサートより、バックプレートの方が設置しやすい構造になっています。

7



バックプレートをもとの位置に戻します。プレートの向きが正しいことを確認して下さい。

プレートの尖部から乳房の凹部に挿入します。


8



バックプレートの底部までしっかりと覆います。


これで準備ができました。

9

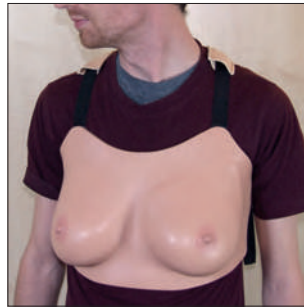

トルソや模擬患者に装着し使用してください。

1

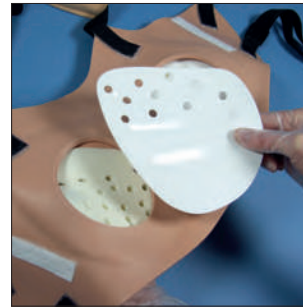

乳房診察トレーナーのインサートは素材の性質上、胸部の皮膚表面に吸着してかたまりのような外観となる場合があります。ここではその解消法を説明します。

乳房を下向きにして置き、バックプレートを取り出します。

2



病変サポートを取り出してから、乳房診察用インサートを取り出します。

3



インサートが乳房の肌の内側にくっつかないようにするために、少量のベビーパウダーを、乳房の凹面に塗布し、まんべんなくなじませてください。